

单一来源论证签到表

项目名称：成都市第三人民医院钇-192 放射源采购项目

论证时间：2024 年 3 月 20 日

序号	姓名	工作单位	专家证号	联系电话
1	徐元昌	成都军区总医院	SC0100065	18908177281
2	李斌	中建大学设计院	SC0100532	1366195666
3	李斌	中建大学设计院	SC20045081	13618008535

注：请签名时请使用楷体书写

单一来源采购专业人员论证意见

采购单位	成都市第三人民医院
项目名称	成都市第三人民医院铱-192 放射源采购项目
采购内容	铱-192 放射源
拟采购的货物或服务的说明	1、材质要求：铱-192 材质的放射源。 2、数量：3 颗 3、预算金额：43.2 万元
采用单一来源采购方式的原因及说明	成都市第三人民医院拟采购铱-192 放射源 3 颗用于后装治疗机使用，现后装治疗机为核通（荷兰）有限公司生产的 Flexitron HDR 型号后装治疗机。 1、后装机是使用铱-192 放射源进行放射治疗的设备，按照临床治疗要求，需要根据放射源半衰期定期更换。 2、Flexitron HDR 型号后装治疗机用户说明书中已明确说明：后装机系统设计只使用 Nucletron 提供的零件、耗材和放射源使用和维护。 3、由于不同生产厂家的后装治疗机使用的 192 放射源源芯尺寸及包壳尺寸不同，若使用非标准尺寸的放射源容易发生卡源问题而造成辐射事故。除此之外，放射源所辐射出来的射线的能谱和剂量分布要与采购人现有的内照射计划系统建模参数匹配。故只能采用原厂的铱-192 放射源。 故建议该设备的放射源采用单一来源采购方式，由该设备生产厂家提供。医科达（上海）医疗器械有限公司为生产厂家（Nucletron）唯一授权公司。 综上，本次采购符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一项“只能从唯一供应商处采购”的规定，适用于单一来源采购，建议采用单一来源方式进行采购。

李 红 李

	拟定供应商：医科达（上海）医疗器械有限公司。 供应商地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1528 号、竹林路 101 号 1803 单元（实际楼层第 16 层）。
联系方式	采购人：成都市第三人民医院 地址：成都市青龙街 82 号。 联系人：唐老师 联系电话：028-61318496 采购代理机构：四川成与诚招标代理有限公司 地 址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号新世纪环球中心 S1 区 16 楼 1625 号 联系人：敬芸芸 联系电话：028-83475775、19180725816

敬芸芸

专业人员姓名	徐沁	工作单位	成都市第三人民医院	职称	副主任医师
专业人员 论证意见	成都市第三人民医院10前使用的⁶⁰Co治疗机为 模达(荷兰)有限公司生产,其型号为Flexitron HDR,其 中装有铱-192放射源。放射源(铱-192)是放 射性物质,有半衰期,达到半衰期需要更换,该后 装治疗机只能使用由荷兰Nucletron公司生产的铱-192 放射源。其公司生产的铱-192放射源与元法达机匹 配。是独一无二的。医科达(上海)医疗器械有限公司 为该放射源生产厂家(Nucletron)在中国的唯一授权公司 负责在全国的销售。根据《中华人民共和国政府与欧洲 共同体关于互认的协定》,通过国家计量局测试,该证成为 签名: 医科达(上海)医疗器械有限公司 徐沁				
专业人员姓名	姜斌	工作单位	重庆大学医院	职称	主任医师
专业人员 论证意见	本人目前正在使用模达(荷兰)公司生产的Flexitron HDR型后装治疗机。 ①.该机需同铱-192放射源,现已到半衰期定期更换 期。 ②.生产厂家标明放射源铱-192只能使用荷兰Nucletron 公司产品,其每枚放射源都有唯一被识别的编码,刻在核 源机头可识别和使用。 ③.目前国内无其他公司生产的铱-192能用于Flexitron HDR后装治疗。 综上:建议采用单一来源方式采购。医科达(上海)公 司是生产厂家(Nucletron)唯一授权公司,符合采购法第 三十一条之规定。拟定供应商:医科达(上海)医疗器械有限公司。 地址:上海自贸世纪大道1528号,101号1803单元 姜斌				

专业人员姓名	郭海松	工作单位	四川省肿瘤医院	职称	主任医师
专业人员 论证意见	成都市第二人民医院前使用的放疗机为捷通(荷兰)有限公司生产的Flexitron HOK型号。该机使用钴-192放射源进行放射治疗,按照放射源的要求需要根据放射源半衰期更换。放射源所辐射出来的射线和剂量率分布要与放疗机现有的内部射计划系统建摸参数匹配,只待更换原厂钴-192放射源。故建议该设备的放射源采用单一源方式,由该设备生产厂家提供。原科达(上海)医疗器械有限公司为生产厂家(Nucletron)唯一授权公司。 综上:该设备符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购”的规定,建议采用单一源方式进行采购。 签名: 郭海松				

附: 专家证

郭海松



四川省政府采购评审专家



姓名：徐元昌

身份证号：510106196210159812

证书编号：SC0100065

当前状态：资格正常

职称信息：副主任医师

本证书由四川省财政厅颁发，表明持证人具备四川省政府采购评审专家评审资格。此证书信息来自评审专家库，相关信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。网络验证的唯一合法网站为：四川政府采购网（<http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/>）。




发证日期：2022-08-05
业务专用章





四川省政府采购评审专家

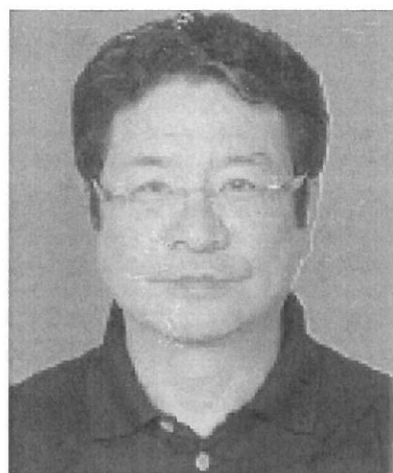

姓名：黄大斌

身份证号：510103195403092534

证书编号：SC0100532

当前状态：资格正常

职称信息：主任医师

本证书由四川省财政厅颁发，表明持证人具备四川省政府采购评审专家评审资格。此证书信息来自评审专家库，相关信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。网络验证的唯一合法网站为：四川政府采购网（<http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/>）。



发证日期：2021-08-09
业务专用章





四川省政府采购评审专家

资格证书



姓名：颜海婴

身份证号：510102195506083781

证书编号：SC26045081

当前状态：资格正常

职称信息：主任医师

本证书由四川省财政厅颁发，表明持证人具备四川省政府采购评审专家评审资格。此证书信息来自评审专家库，相关信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。网络验证的唯一合法网站为：四川政府采购网（<http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/>）。



发证日期：

